



وزارة الطاقة والثروة المعدنية

شراء وحدات UPS للاجهزة

XRD و XRF و AAS

عطاء رقم 4/ع/لوازم/2026

2026

الشروط خاصة اضافة للعطاء رقم (4/ع/لوازم/2026)

1. يعتبر تقديم عرض المناقص بأنه مطلع ومتفهم وملتزم بجميع مواد وتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء.
2. يرفق بالعرض تأمين لدخول العطاء على شكل كفالة بنكية صادرة عن بنك محلي (240) دينار وسوف لن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب ولا تقبل الشيكات .
3. يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وان تكون مدة سريان الكفالة تغطي مدة سريان العرض وبخلاف ذلك للجنة الشراء الرئيسية /لوازم الحق في استبعاد العرض المقدم .
4. يعتبر صدور قرار الإحالة المبدئي وإشعار المناقص به ملزماً له.
5. يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد مع بيان السعر الافراضي والإجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ والاسم التجاري والطرز (MODEL) واسم الشركة الصانعة وإرفاق الكتالوجات مع العروض.
6. يجب أن يكون المناقص من ذوي الاختصاص وإرفاق صورة عن رخصة المهن سارية المفعول والسجل التجاري وتبين وبشكل واضح عنوانها الدائم (الموقع البريد الالكتروني/ الهاتف/ الفاكس...) ومشارك بنظام الفوترة الالكتروني .
7. تقدم الأسعار بالدينار الأردني، بحيث تكون الأسعار شاملة التوريد والتركيب والتشغيل والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية.
8. يلتزم المتعهد بدفع رسوم الطوابع المستحقة بعد تبلغ قرار الإحالة و قبل توقيع أمر الشراء .
9. يلتزم المتعهد بتقديم تأمين حُسن تنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة (10%) من قيمة اللوازم المحالة عليه بعد تبلغ قرار الإحالة و قبل توقيع أمر الشراء .
10. يلتزم المتعهد بان تكون اللوازم الموردة جديدة (100%) اصلية وخالية من أي عيوب في الصنع أو في المادة ومن طراز حديث.
11. يلتزم المتعهد بتقديم تأمين صيانة بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم المحالة عليه لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام النهائي .
12. يلتزم المتعهد بالصيانة المجانية لمدة 5 سنوات شامله البطاريه بحيث تشمل اعمال الصيانة وقطع الغيار ويتم الاستبدال في حال ظهور سوء مصنعية ولا تقبل الصيانة .
13. يلتزم المتعهد بتقديم جميع الضمانات باسم معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لوظيفته وتثبيت اسمه ورقم العطاء مع بيان نوع التأمين .

14. توريد الجهاز خلال 40 يوم من تاريخ توقيع امر الشراء.
15. تفرض غرامات التأخير وفقاً لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتحسب بواقع (10) ديناراً عن كل يوم تأخير وبما لا يزيد عن (15%) من قيمة الاحالة.
16. يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والتركيب والتشغيل وتقديم مطالبة مالية والاستلام النهائي
17. في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب قرار الإحالة يحق للجنة الشراء الرئيسية لوائح مصادرة تأمين حُسن التنفيذ كلياً أو جزئياً والشراء على حسابه وتحمله فروق الأسعار بالاضافة الى ما ورد في البند (15).
18. يحق للجنة الشراء الرئيسية / لوائح إهمال أي عرض مخالفاً للشروط و/ أو المواصفات الواردة بدعوة العطاء.
19. يحق للجنة الشراء الرئيسية / لوائح الغاء دعوة العطاء أو أي بند من بنوده أو قرار الاحالة أو اعادة الطرح في أي وقت أو أي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار الاحالة.
20. يحق للجنة الشراء الرئيسية / لوائح زيادة أو انقاص الكميات المطلوبة قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص أو بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية.
21. تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات لسنة 2022 والشروط العامة والخاصة وتكون ملزمة للمناقصين.
22. تقدم كافة وثائق العرض الفني والمالي ووثيقة العطاء موقعة ومحتومة وكفاله دخول العطاء ضمن مغلف مكتوب عليه اسم ورقم العطاء واسم المناقص وخلافاً لذلك يتم استبعاد العرض.

مواصفات وحدة أال UPS لجهاز (PinAAcle 900T) / Perkin Elmer GF-AAS مع وحدة التبريد

- 1- Power - 15 KVA
- 2- Input power: Single phase 200V to 250V AC 50Hz
- 3- Output power: Single phase 230V AC 50 Hz
- 4- Output Voltage regulation: $\pm 1\%$
- 5- Output Frequency: ± 0.1 Hz
- 6- PF (power factor) ≥ 0.9
- 7- Pure sine wave.
- 8- Backup time (Run Time): 15 minutes. (The rated load is about 12KW)
- 9- LCD panel to monitor the status, diagnoses, and control.
- 10- Online double - conversion.
- 11- Zero transfer time.
- 12- It should include:
 - Surge protection.
 - Short circuit and over load protection.
 - Back-feed protection.
- 13- Including installation, and all needed cables, CB, and any accessories.
- 14- Demonstration and test after installation, for 3 times during one week next to Installation.
- 15- Five years warranty including battery.
- 16- Real Earthing to protect the system.
- 17- Manufacturing year is the same as Delivery year.
- 18- Deleviry period: Not more than 40 days from Purchase Order date.

أهال أبو عامر
Zabih

مواصفات وحدة ال UPS لجهاز XRF-S8 and Chiller

- 1- Power - 20 KVA
- 2- Input power: 3-Phase 400 VAC+ N \pm 10 %, 50Hz, (3 \times 50A)
- 3- Output power: 3-Phase 400VAC +N, 50Hz, (3 \times 32A for XRF, 3 \times 16A for chiller)
- 4- Output Voltage regulation: \pm 1%
- 5- Output Frequency: \pm 0.1 Hz
- 6- PF (power factor) \geq 0.9
- 7- Pure sine wave.
- 8- Backup time (Run Time): 15 minutes. (The rated load is about 12KW)
- 9- LCD panel to monitor the status, diagnoses, and control.
- 10- Online double - conversion.
- 11- Zero transfer time.
- 12- It should include:
 - Surge protection.
 - Short circuit and over load protection.
 - Back-feed protection.
- 13- Including installation, and all needed cables, CB, and any accessories according to the attached schematic diagram.
- 14- Demonstration and test after installation, for 3 times during one week next to installation.
- 15- Five years warranty including battery.
- 16- Real Earthing to protect the system.
- 17- Manufacturing year is the same as Delivery year.
- 18- Deleviry period: Not more than 40 days from Purchase Order date.


ل. د. دانيال سعادان
سعادان

أ. غزال يوسف
غزال


مواصفات وحدة ال UPS لجهاز XRD, D4

- 1- Power - 10 KVA
- 2- Input power: 3-Phase 400 VAC +N \pm 10 %, 50Hz (3 \times 32A)
- 3- Output power: 3-Phase 400VAC +N, 50Hz(3 \times 32A)
- 4- Output Voltage regulation: \pm 1%
- 5- Output Frequency: \pm 0.1 Hz
- 6- PF (power factor) \geq 0.9
- 7- Pure sine wave.
- 8- Backup time (Run Time): 15 minutes. (The rated load is about 12KW)
- 9- LCD panel to monitor the status, diagnoses, and control.
- 10- Online double - conversion.
- 11- Zero transfer time.
- 12- It should include:
 - Surge protection.
 - Short circuit and over load protection.
 - Back-feed protection.
- 13- Including installation, and all needed cables, CB, and any accessories.
- 14- Only XRD - D4, will be connected to UPS. (Without Chiller).
- 15- Demonstration and test after installation, for 3 times during one week next to Installation.
- 16- Five years warranty including battery.
- 17- Real Earthing to protect the system.
- 18- Manufacturing year is the same as Delivery year.
- 19-Deleviry period: Not more than 40 days from Purchase Order date.

محمد زهران

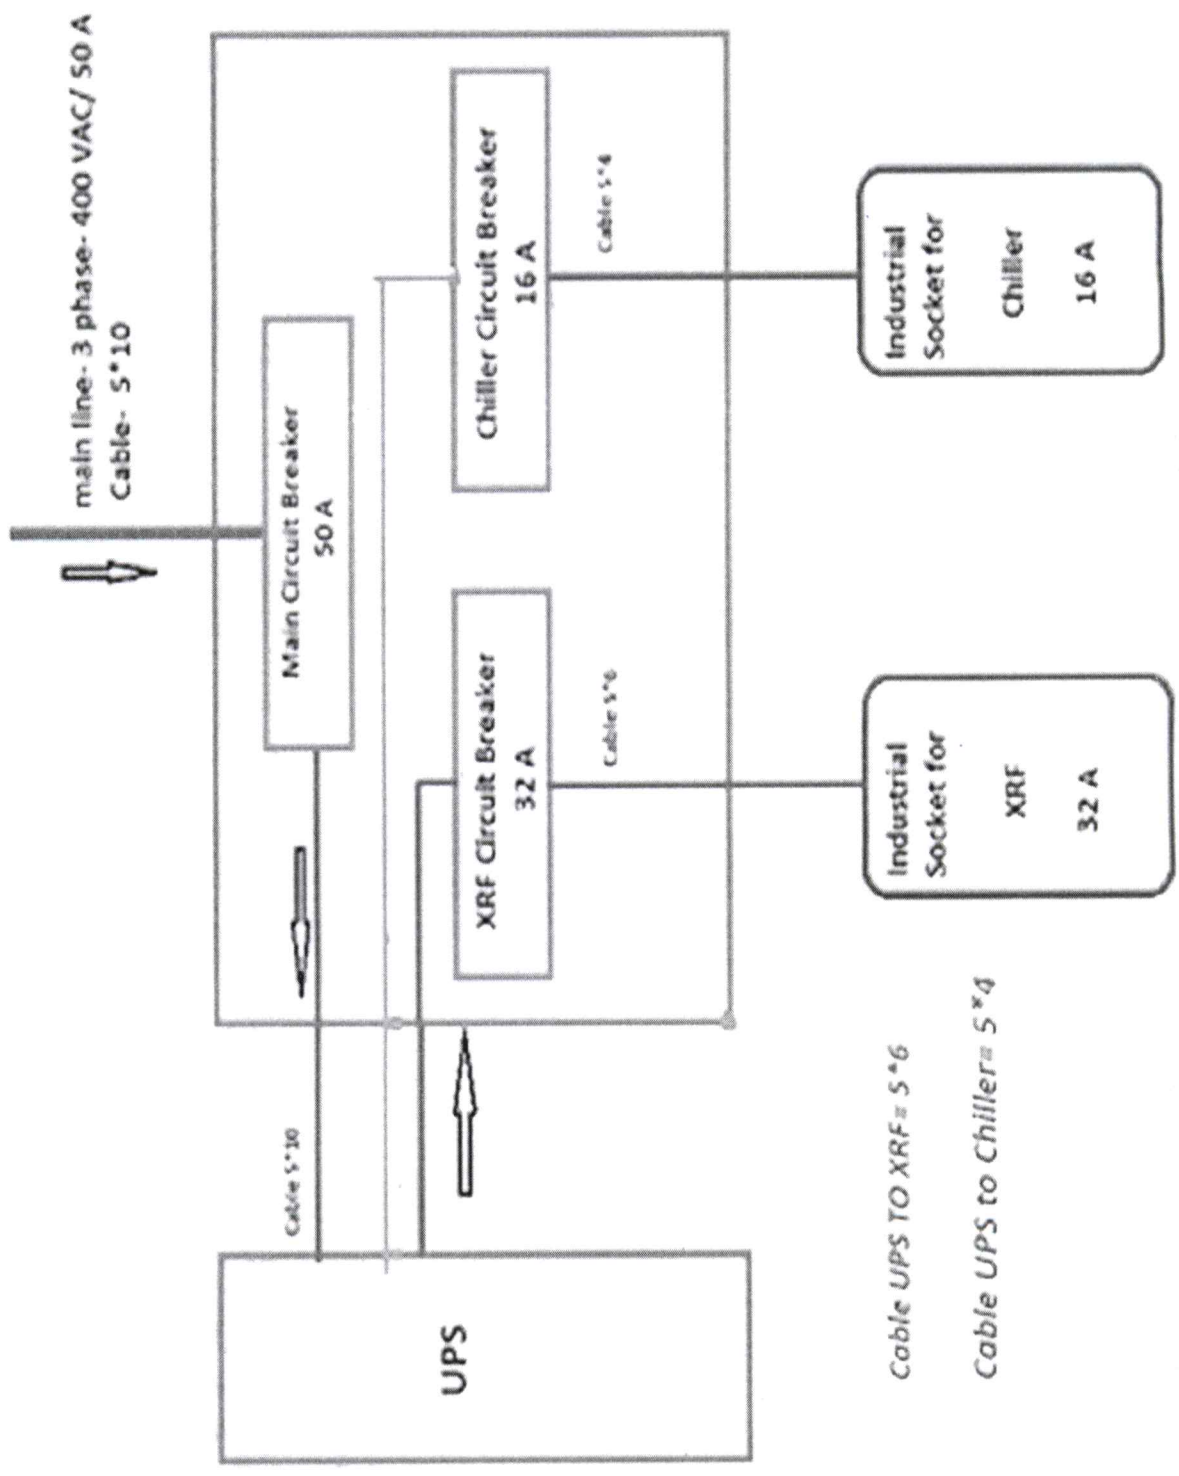

م. فریال یوسف
ایو

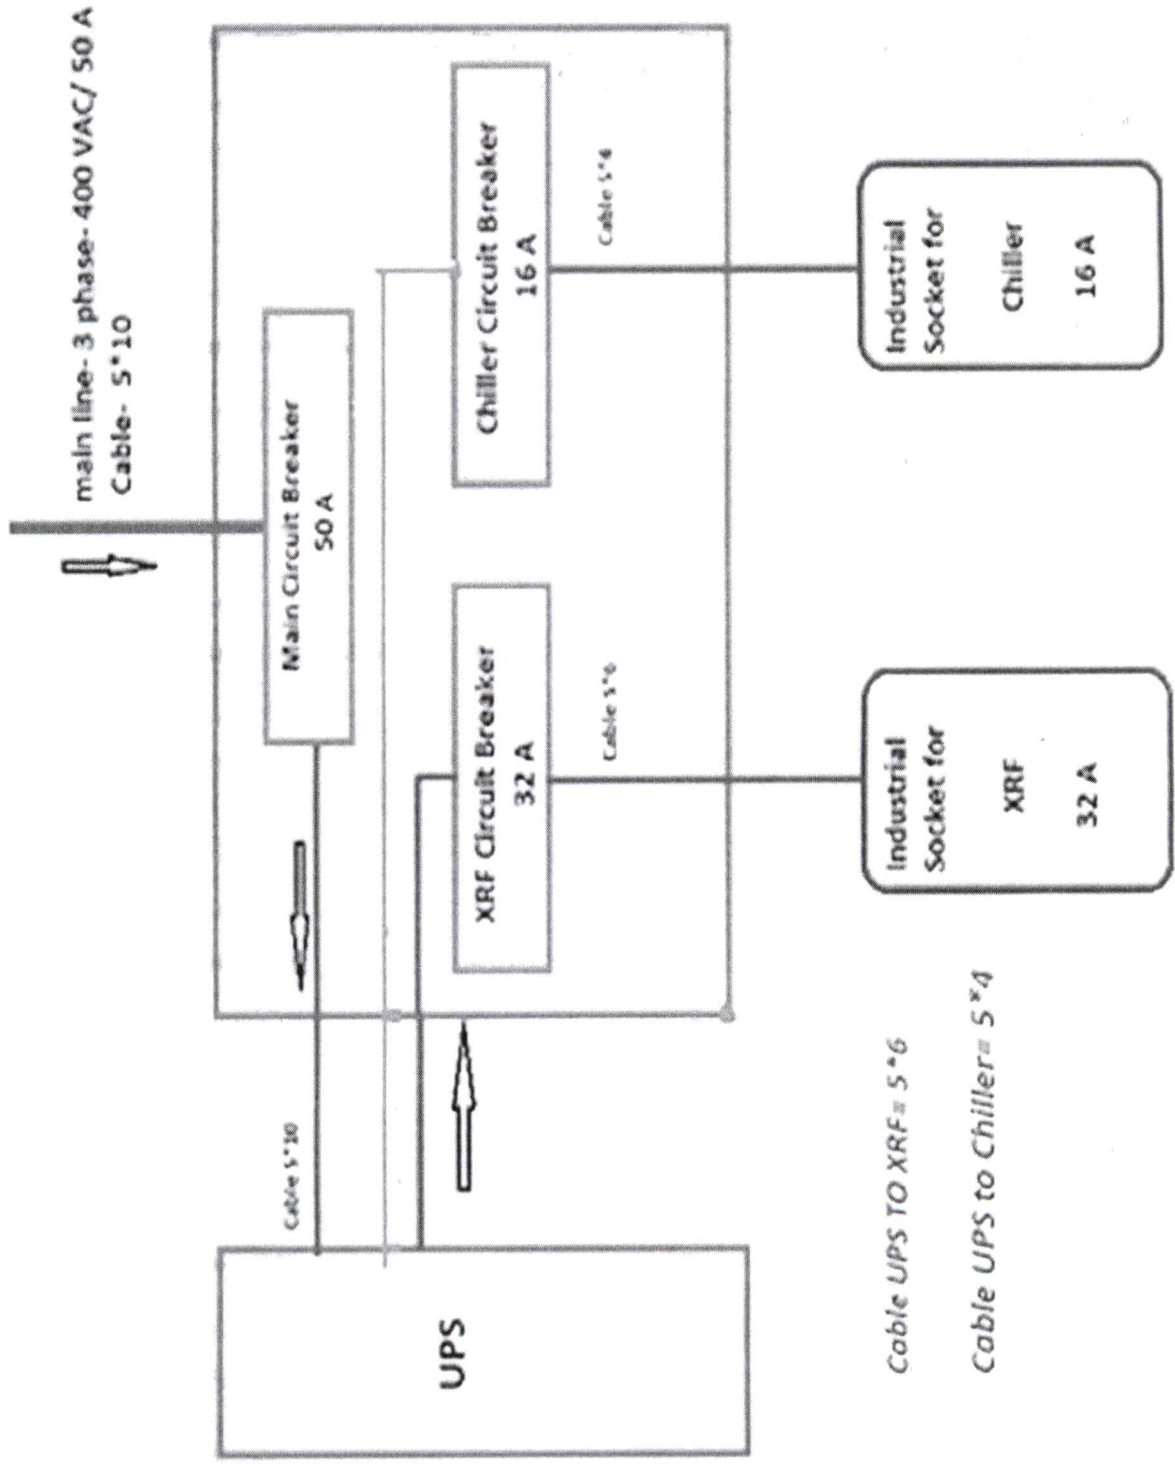

Cable UPS TO XRF = 5*6

Cable UPS to Chiller = 5*4

م. فریال یوسف
 سید

البنك : _____

سند كفالة دخول العطاء

السادة : وزير الطاقة والثروة المعدنية بالاضافة الى وظيفته

التاريخ : ___ / ___ / 202م

تاريخ الاستحقاق : ___ / ___ / 202م

رقم الكفالة : (_____)

تحية طيبة وبعد،،،

يكفل البنك _____ فرع _____

السادة / المناقص _____

بمبلغ (_____) دينار فقط _____

لمدة _____

وذلك ضماناً لدخول العطاء رقم (_____)

الخاص بشراء (_____)

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزءٍ منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد الى البنك يجب أن تكون في/أو قبل موعد استحقاقها وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.

• لا تقبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي شرط يعيق التمديد و الدفع وترفض أي كفالة تتضمن مثل هذا الشرط.

البنك

سند كفالة صيانة

السادة :

الفرع :

التاريخ : / / 20

رقم الكفالة :

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة / المتعهد

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة رقم (/) المنبثق عنه أمر
الشراء رقم (.....).

المتعلق بتوريد

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بكتاب رسمي من (اسم الجهة

المستفيدة)

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية

منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.

البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

السادة:

التاريخ: 202 / /

تاريخ الاستحقاق: 202 / / م

رقم الكفالة: ()

تحية وبعد،،،

يكفل بنك

فرع

السادة / المتعهد

بمبلغ () دينار فقط

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة رقم () الخاصة بالعطاء رقم ()

المتعلق بتوريد

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية 202 / / م

ويتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة أو بدفع قيمتها إليكم أو أي جزءٍ منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع، وذلك خلال فترة سريانها، ولا تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها إلا بكتاب رسمي من

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها

عند الطلب، فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب

بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

• لا تقبل أي شرط يعيق التمديد والدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل.